Miele
PROFESSIONAL

Dental Thermal Disinfector

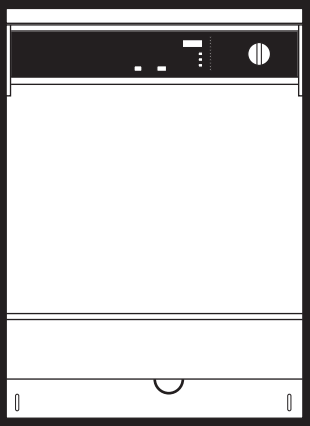

G7891

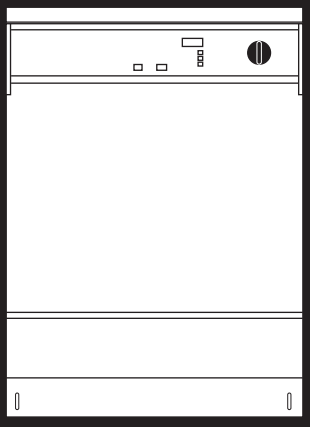

G7881

G7831

設置・施工手順書

G7891/G7881
G7831
歯科用洗浄機

● この設置・施行手順書では、人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

● 設置・施工において、設置説明書に従わなかったために生じた故障・事故などについては責任を負いかねます。

ミーレ・ジャパン株式会社

1 安全上のご注意

この設置・施行手順書では、次のマークの箇所で人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。	お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。
⚠警告 「死亡や重傷を負うおそれがある」内容です。	してはいけない内容です。
⚠注意 「傷害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある」内容です。	実行しなければならない内容です。

※設置・施行手順書に従わなかったために生じた故障・事故などについては責任を負いかねます。

2 設置上の注意（所要設備・電源）

⚠警告

- 給水：作動水圧2.5～10kg/cm2
- ビルトインする場合、天板下部から床面まで830mm以上確保してください。
- 機器はシンク・キャビネットの近くに設置するように留意してください。
- 歯科用洗浄機は全てポンプによる強制排水方式です。（揚程1m）
  排水管は必ず500mm以上立ち上げてください。
- 給水バルブはユーザーが容易に操作できるような向きで取り付けてください。
- 電源、給排水は左右いずれかの場合に設備します。
- 必ず給水配管を行ってください。



- 電源工事や接地工事は電気設備技術基準に準じて行ってください。
- 排水管は耐熱塩ビ管HTを使用してください。（HT40相当）
  G7881、G7891では93℃の熱湯が9.5L、G7831では5.5L排水されます。
- 排水工事はすべて水道法、建築基準法、および貴都市の条例、規定に準じて行ってください。
- 設置床面は水平・平坦にし、後で本体を手前にひきだせるようにしておいてください。

- 電源コードを切断し、直結することは絶対にしないでください。
- 凍結の恐れがある場所（室温0℃以下）には設置しないでください。

3 所要設備（電源・給排水管配置）:G 7891

専用回路の設置（G 7891）

■ブレーカー付単相200V・20A専用回路

60cmタイプ　G7891　三相200V/50Hz/20A　三相200V/60Hz/20A　明工社MR2749と同等品

給排水管の配置（G7891）

RO水を使用する場合（給水管×2）

● 給水管×2 ： 1/2"アングル止水栓
（TOTO THY226U相当品）
FL500mm以上立ち上げ

● 排水管 ： 耐熱塩ビ管40φ（HT40相当）
FL500mm以上立ち上げ

★右記の設備例は代表的な方法です。現場に応じて給・排水管、コンセントの位置は変えてください。
（各ホースの長さは1.5mです。）

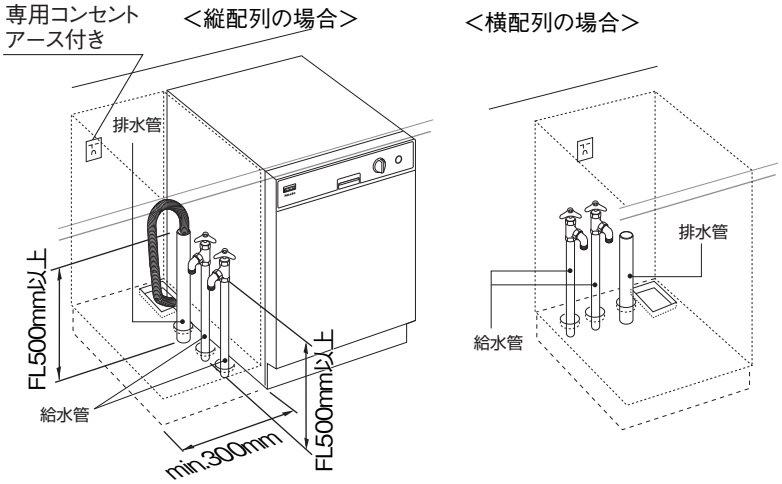

RO水を使用ししない場合

● 給水管 ： 1/2"アングル止水栓
（TOTO THY226U相当品）
FL500mm以上立ち上げ

● 排水管 ： 耐熱塩ビ管40φ（HT40相当）
FL500mm以上立ち上げ

★右記の設備例は代表的な方法です。現場に応じて給・排水管、コンセントの位置は変えてください。
（各ホースの長さは1.5mです。）

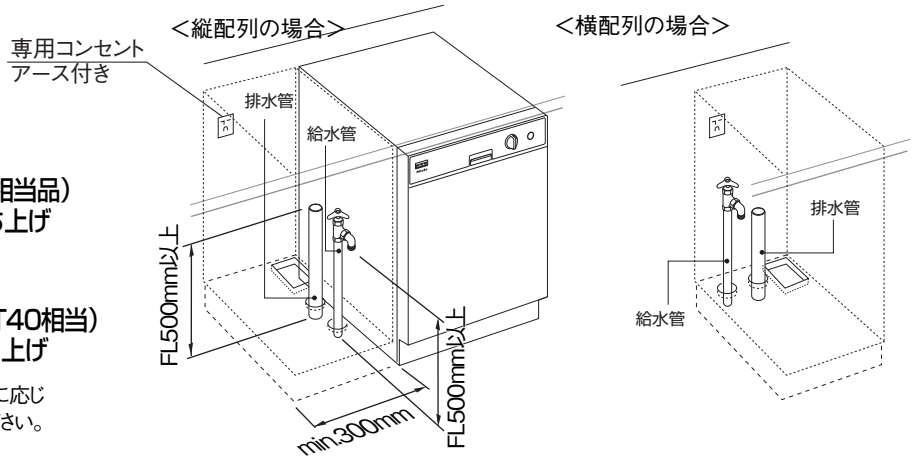

同梱部材リスト(G 7891)

機種により梱包されている部材が異なります。設置・施工前に部品の確認をしてください。

部品名・姿図・個数	❶ ホースバンド	❷ ストレーナー（セット）	❸ カウンター保護板	❹ 排水ホース	❺ 取扱説明書 保証書	❻ 排水ホースガイド	❼ DOSタンク	❽ じょうご	❾ ホースアダプター	❿ 1／2" エルボ	⓫ Y字分岐管
G7891	○ ×2	○ ×2	○	○ ×2	○	○ ×2	○	○	○ ×2	○ ×2	○

3 所要設備（電源・給排水管配置）：G 7881 G 7831

専用回路の設置（G 7881 / G 7831）

■ブレーカー付単相200V・20A専用回路

60cmタイプ	G7881	三相200V/50Hz/20A 三相200V/60Hz/20A	明工社MR2749と同等品
45cmタイプ	G7831	単相200V/50-60Hz20A	松下WN1932と同等品

給排水管の配置（G 7881 / G 7831）

〈図はG7881のもの〉

● 給水管 ： 1/2"アングル止水栓
（TOTO THY226U相当品）
FL500mm以上立ち上げ

● 排水管 ： 耐熱塩ビ管40φ（HT40相当）
FL500mm以上立ち上げ

★ 上記の設備例は代表的な方法です。現場に応じて給・排水管、コンセントの位置は変えてください。
（各ホースの長さは1.5mです。）

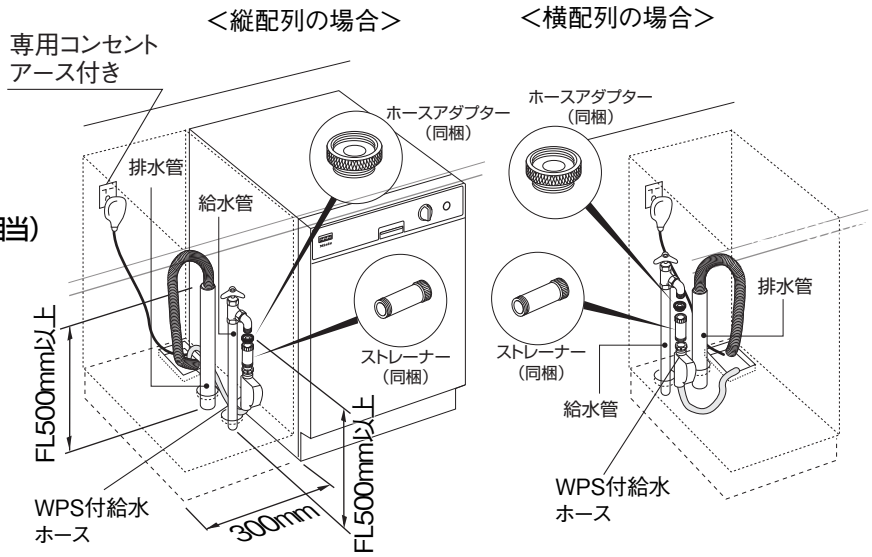

同梱部材リスト（G 7881 / G 7831）

機種により梱包されている部材が異なります。設置・施工前に部品の確認をしてください。

部品名・姿図・個数	❶ ホースバンド	❷ ストレーナー（セット）	❸ カウンター保護板	❹ 排水ホース	❺ 取扱説明書 保証書	❻ 排水ホースガイド	❼ DOSタンク	❽ じょうご	❾ ホースアダプター	❿ 1／2" エルボ	⓫ Y字分岐管
G7881	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×
G7831	○	○	○	○	○	○	×	×	○	○	×

3 設置場所-(G7891…RO水ホース使用の場合)

キャビネット開口寸法および底板の加工方法(RO水ホース使用の場合)

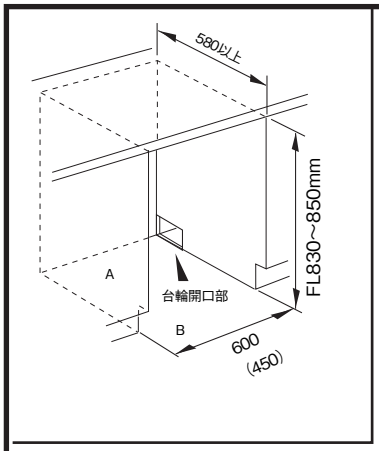

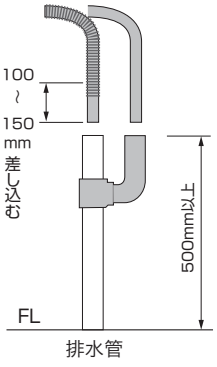

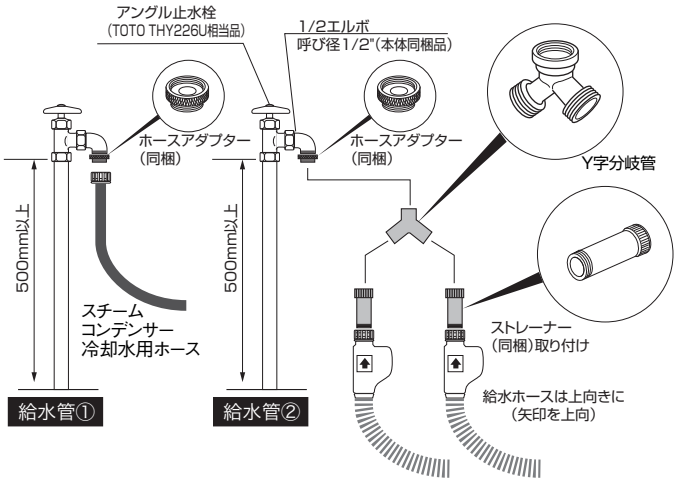

必ずエアー抜きをしてください。

■隣接キャビネットの加工例

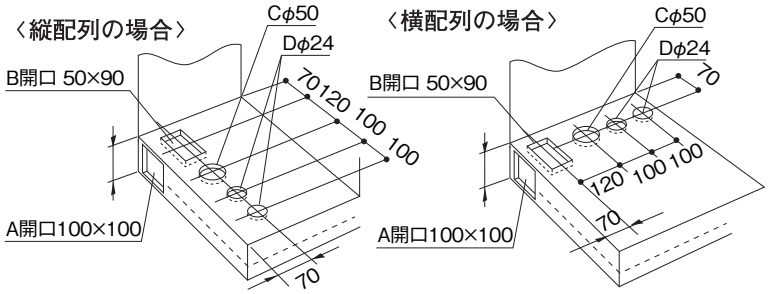

A ー 給排水ホース・電源コード通し穴
B ー 給排水ホース・電源コード引き込み穴
C ー 排水管通し穴
D ー 給水管通し穴(×2)

● 上記のキャビネット加工例は代表的な方法です。現場に応じてC、Dの位置は変えてください。

1. 電源の接続

電源コードをコンセントに差し込みます。

60cmタイプ **G7891**

三相200V/50Hz/20A,
三相200V/60Hz/20A

明工社MR2749同等品

2. 給排水の接続

スチームコンデンサー冷却水用ホースを、ホースアダプターを使って給水管①に、給水ホース及びRO水給水ホースをY字分岐管を取り付けた給水管②に接続します。
排水ホース2本を図のように止水栓と接続します。

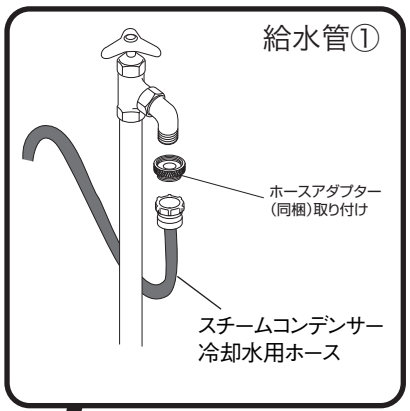

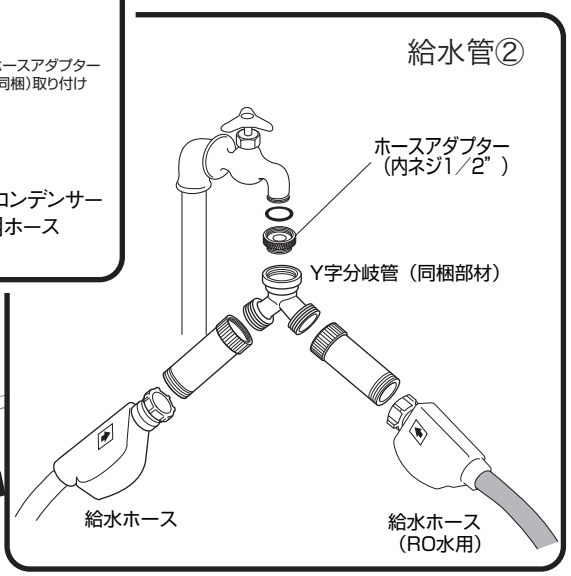

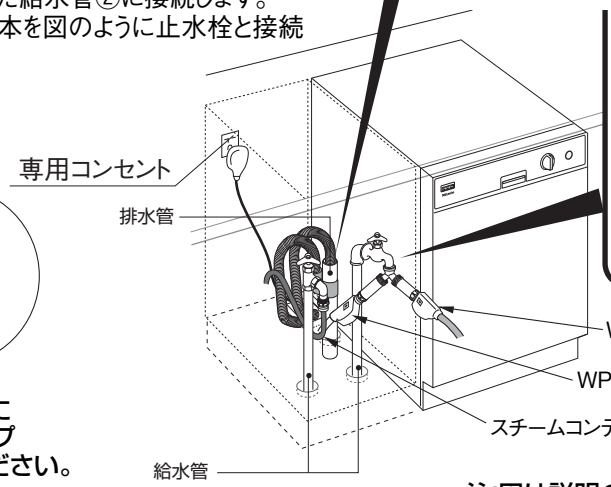



排水ホースは,
抜けないように
ビニールテープ
で固定してください。

注:図は説明のため、指定の寸法よりも離して描かれています。

3 設置場所-(G7891…RO水ホース使用しない場合)

キャビネット開口寸法および底板の加工方法(RO水ホースを使用しない場合)

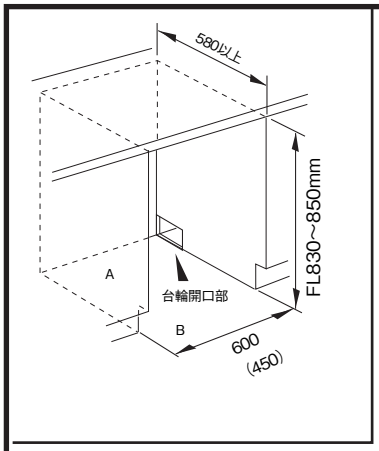

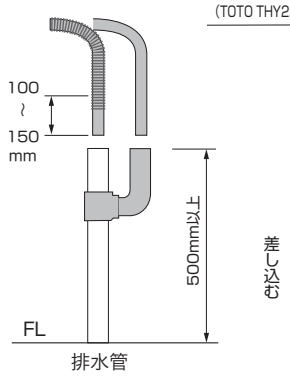

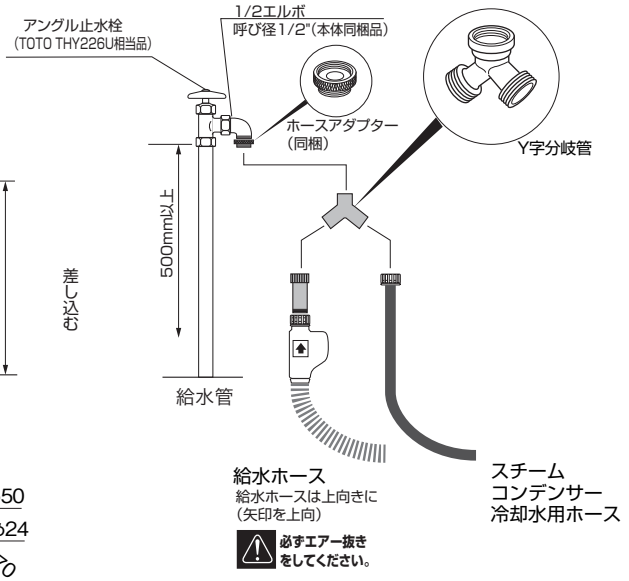

■隣接キャビネットの加工例

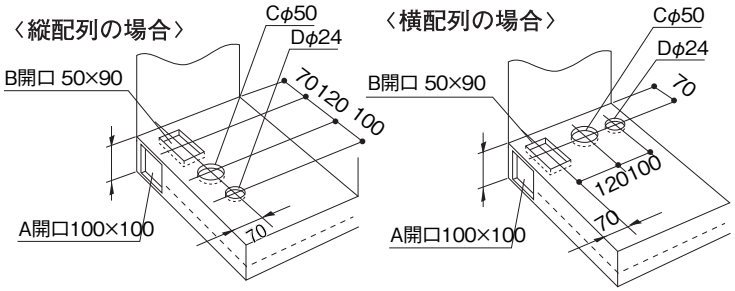

A ー 給排水ホース・電源コード通し穴
B ー 給排水ホース・電源コード引き込み穴
C ー 排水管通し穴
D ー 給水管通し穴

● 上記のキャビネット加工例は代表的な方法です。現場に応じてC、Dの位置は変えてください。

1. 電源の接続

電源コードをコンセントに差し込みます。

60cmタイプ **G7891**

三相200V/50Hz/20A,
三相200V/60Hz/20A

明工社MR2749同等品

2. 給排水の接続

スチームコンデンサー冷却水用ホース及び給水ホース
をY字分岐管を取り付けた給水管に接続します。

排水ホース2本を図のように止水栓と接続します。

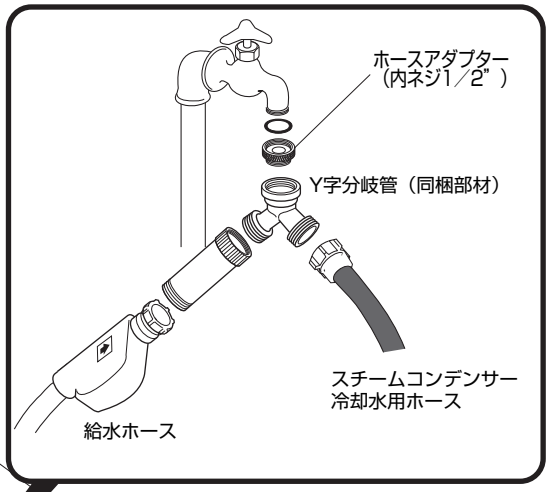

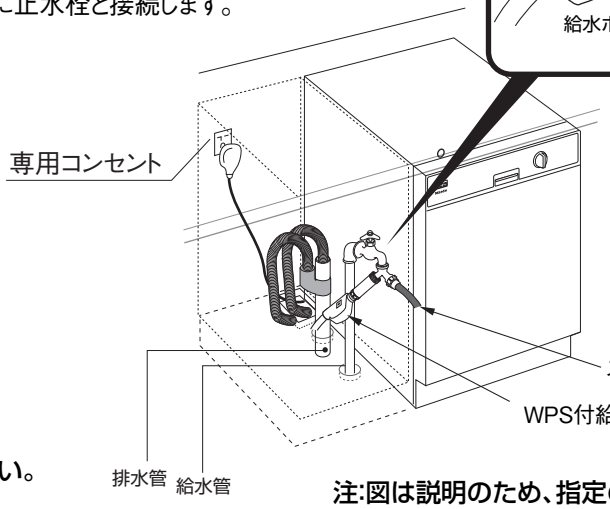

※RO水給水ホースは接続しないので本体裏面に吊し、付属のバンドで固定しておいてください。



排水ホースは,
抜けないように
ビニールテープ
で固定してください。

注:図は説明のため、指定の寸法よりも離して描かれています。

3 設置場所-その2(G7881／7831)

キャビネット開口寸法および底板の加工方法

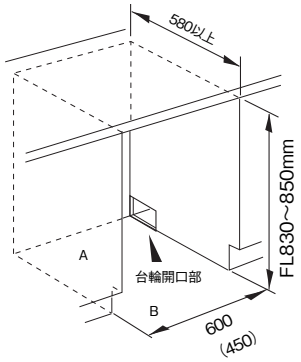

■隣接キャビネットの加工例

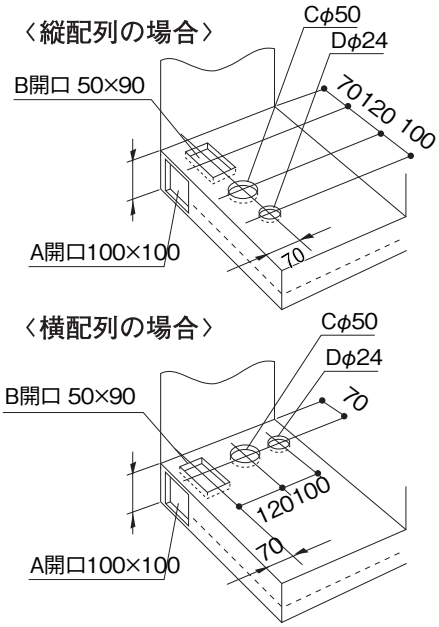

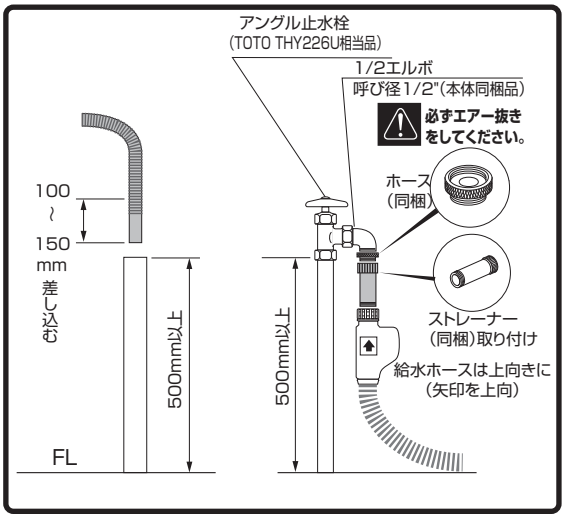

A ― 給排水ホース・電源コード通し穴
B ― 給排水ホース・電源コード引き込み穴
C ― 排水管通し穴
D ― 給水管通し穴

● 上記のキャビネット加工例は代表的な方法です。現場に応じてC、Dの位置は変えてください。

1. 電源の接続

電源コードをコンセントに差し込みます。

60cmタイプ G7881
三相200V/50Hz/20A,
三相200V/60Hz/20A
明工社MR2749同等品

45cmタイプ G7831
単相200V/50-60Hz20A
松下WN1932と同等品

2. 給排水の接続

給水ホース及び排水ホースを図のように止水栓と接続します。



排水ホースは,
抜けないように
ビニールテープ
で固定してください。

<縦配列の場合>

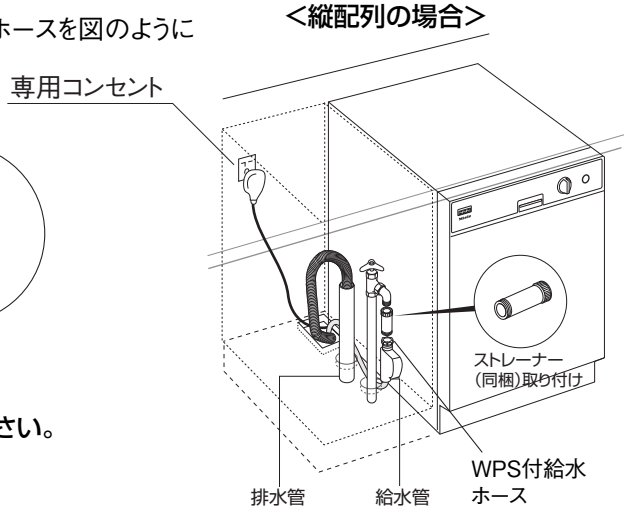

<横配列の場合>

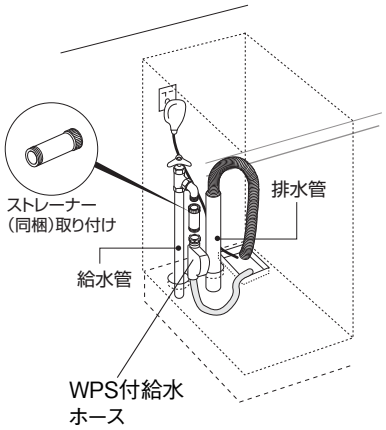

3 設置場所-その3

設置場所に関しての注意事項

■機器周辺の壁（他の機材等も含む）からの距離

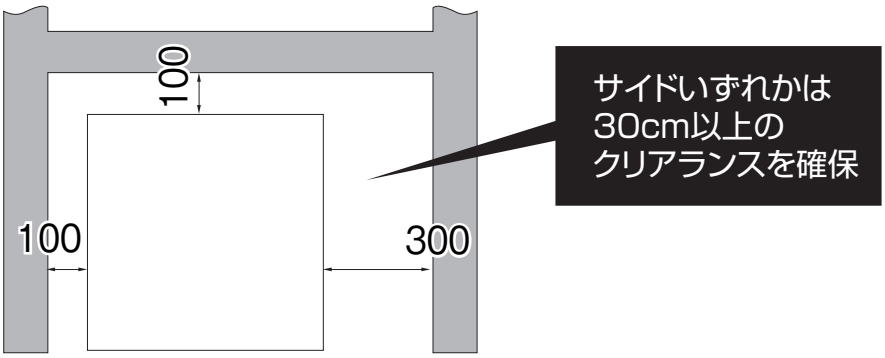

機械周辺のクリアランス

歯科用洗浄機には機械のまわりの換気が必要です。
左右いずれかのサイドと背中側に最低限10cm、もう片サイドは配管や電源接続のために30cm以上のクリアランスをとってください。

Miele
PROFESSIONAL

設置後、かならず試運転を行ってください。水漏れや異常音、本体の傾きがないこと、正常に排水することをご確認ください。

ミーレ・ジャパン株式会社

〒150-0063 東京都目黒区目黒2-10-11 目黒山手プレイス
電話(03)5740-0030(代) FAX(03)5740-0035

お問い合わせは…
ミーレ・コンタクトセンター
0120-310-647(通話無料)
■受付時間　9：00～17：30(土日・祝祭日休業)

Pro-Dent-Inst+-130312